



Easy Start

Online Shop

HU

MAM Anti-Colic cumisüveg

Az első használat előtt

- Az első használat előtt szerelje szét és tisztítsa meg a terméket, majd tegye a cumisüveg részait 5 percre forrásban lévő vízbe. Ez biztosítja a higiéniát. A tisztításról többet megtudhat az erről szóló fejezetben.
- Az első használatkor és a későbbi használat során alkalmanként, a szellőzőnyílás (az etetőcumi alsó karéjának alján lévő buborékban) összeragadhat. Ez akadályozza meg a levegő bejutását a cumisüvegbe az etetés során, és ennek következtében az etetőcumi összetapad. Néhányszor lassan húzogassa át a (szellőző) buborékot hüvelykujjával vagy ujjával, a rés újbóli megnyitásához.

Tisztítás

- Minden használat előtt szerelje szét és óvatosan tisztítsa meg a terméket meleg szappanos vízzel. Sterilizálás előtt alaposan öblítse el tiszta vízzel a higiénia biztosítása érdekében. Kerülje a káros összetevőket a szappanban, mint az alkohol, klór és/vagy mikroműanyagok. Ne hagyja az alkatrészeket az ajánlottnál hosszabb ideig a tisztítószerben, például a szappanos vízben állni, mert az negatívan befolyásolhatja a termék működését.
- Az alkatrészeket minden használat előtt vizsgálja meg és az etetőcumit minden irányban húzogassa meg. Ha károsodás vagy megrongálódás első jelét észleli, cserélje ki.
- A megfelelő tisztításért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni. A tisztítás összeszerelt állapotban károsíthatja a cumisüveget.
- Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható a mosogatógép felső rekeszében (max. 65° C-on). Az alkatrészek az ételszínezékektől elszíneződhetnek.
- Ne használjon agresszív tisztítószereseket. Csak puha kefék és szivacsot használjon. Kemény tárgyak megkarcolhatják a műanyagot.
- Tisztítás és sterilizálás után győződjön meg róla, hogy a cumisüveg részeiben nem maradt élelmiszer.

Sterilizálás

- A megfelelő tisztításért/sterilizálásért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni.
- Minden alkatrészt meg kell tisztítani sterilizálás előtt.
- Tisztítás után a cumisüveg sterilizálásához a következő eljárások egyikét alkalmazhatja: gőzsterilizálás (elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló, a gyártók utasításai alapján), sterilizálás forró vízben legalább 5 percig vagy sterilizáló folyadék használatával.
- Ne hagyja a termék részeit (beleértve az etetőcumit) az ajánlottnál hosszabb ideig sterilizáló oldatban, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak – ez negatívan befolyásolhatja a termék működését és károsíthatja az etetőcumit.
- A sterilizáláshoz vagy önsterilizáláshoz a cumisüveget SOHA ne hagyja összeszerelve, mert az károsíthatja a cumisüveget és eldeformálhatja a meneteket, amelyek mentén a cumisüveget össze kell csavarni.

Az Anti-Colic cumisüveg önsterilizáló funkciója a mikrohullámú sütőben


Az Anti-Colic cumisüveg önsterilizáló funkciója bizonyítottan hatásos az általános háztartási kórokozók és baktériumokkal szemben. Ez egy teljesen hatékony és biztonságos folyamat. A legjobb hatás elérése érdekében figyelmesen kövesse az összes instrukciót és csak a leírás szerint használja. Ez a praktikus és idő- és energiatakarékos funkció 5 egyszerű lépésben történik. Sterilizálás előtt a cumisüveg különálló részeit mindig meg kell tisztítani!

1. lépés: A cumisüveg megtisztított alkatrészeit a következőképpen állítsa össze: Alj rész szilikon szeleppel, etetőcumi a menetes gyűrűvel, cumisüveg test és védőkupak.

2. lépés: Mérjen ki 20 ml hideg vizet a cumisüveg kupakjának segítségével. Öntse a 20 ml hideg vizet a szilikon betétes szelepes aljba.

3. lépés: A menetes gyűrűt az etetőcumival helyezze az aljra. Helyezze rá a cumisüveg testet. FINOMAN csavarja rá, hogy a forró víz kiömlését elkerülje, amikor kiveszi a mikróból. NE CSAVARJA RÁ TELJESEN. Helyezze a védőkupakot a tetejére.

4. lépés: Állítsa be a mikrohullámú sütő időzítőjét az egyszerre sterilizálni kívánt cumisüvegek számának megfelelően. A mikró 500 – 1000 Watt teljesítmény szintre állítsa.

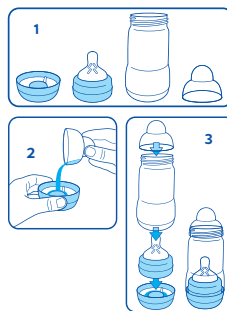

Az egyidőben sterilizálni kívánt cumisüvegek száma	1	2	3	4	5	6
Sterilizálás becsült időtartama (perc)	3	4	5	6	7	8


5. lépés: Sterilizálás után a cumisüveget hagyja kihűlni mielőtt kiveszi a mikrohullámú sütőből. Ajánlott hűtési idő: 10 perc nyitott ajtajú mikróval. Óvatosan fogja meg az aljat és tartsa egyenesen a cumisüveget, amikor kiveszi a mikróból, hogy elkerülje a maradék víz által okozott forrázás veszélyét.

A mikrohullámú sütőben történő sterilizálás után az Anti-Colic cumisüveg akár 48 órán keresztül fertőtlenített marad, amennyiben a 3. lépésben bemutatott módon összeszerelve marad.

- Azonnali használat esetén, a maradék vizet öntse ki. Hagyja az alkatrészeket megszáradni.
- A cumisüveget összeszerelt állapotban tárolja.

Összeszerelés


- Állítsa össze a cumisüveget az alábbi ábra szerint, ellenőrizze, hogy a szelep szorosan/ megfelelően le van nyomva és az alkatrészek megfelelően össze vannak csavarva.
- Ellenőrizze, hogy a szelep a helyén van-e és hogy a cumisüveg alja szorosan van-e rögzítve mielőtt megtölti folyadékkal az üveget.




1. A szilikongyűrűt helyezze a cumisüveg aljába.



2. Nyomja le erősen a szilikonszelepet.



3. Az összeszerelt menetes alját lassan, egyenletesen csavarja a cumisüveg test aljára.



4. Helyezze az etetőcumit a felső menetes gyűrűbe, amíg egy kattanást nem hall.

A helyes mikrohullámú sterilizáláshoz FONTOS TÉNYEK

- Kövesse a mikrohullámú vagy többfunkciós készülék felhasználói kézikönyvében szereplő utasításokat.
- **Ügyeljen arra, hogy az önsterilizáló cumisüveg és a mikrohullámú sütő minden része (beleértve a mikrohullámú belső oldalát és a forgótányért) TELJESEN tiszta és mentes legyen a szennyeződésektől, ételmaradványoktól, zsír- vagy olajfóccsenéstől. Ellenkező esetben a termék megolvadhat, a mikrohullámú sütő szikrázhat vagy a burkolat megéghe!**
- Az Anti-Colic cumisüveget kizárólag szilárd és sík felületre helyezze.
- Ne tegye az Anti-Colic cumisüveget a forgótányér középre, mert az egyenetlen hőelosztáshoz vezethet.
- Ne hagyja őrizetlenül a mikrohullámú sütőt a sterilizálási folyamat alatt!
- Soha ne helyezze a cumisüveget a mikrohullámú sütőbe víz nélkül.
- Azonnal hagyja abba a sterilizálási folyamatot, ha a víz elpárolgott!
- A víz pontatlan kitöltése, a túl sok vagy túl kevés víz károsíthatja a cumisüveget.
- A mikrohullámú sütőn mindig a megfelelő teljesítményt és időt állítsa be.
- Kombinált sütő használatakor ügyeljen arra, hogy az Anti-Colic cumisüveg ne legyen kitéve a grillfunkció forrásának, mert az károsíthatja.
- **ÓVATOSAN** kezelje a sterilizált cumisüveget, mivel még forró lehet.
- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Mosson kezet a sterilizált termék megfogása előtt.
- Óvatosan fogja meg az alját és a sterilizált cumisüveget kivételkor tartsa egyenesen, hogy elkerülje a maradék víz által okozott forrázás esélyét.
- A sterilizált cumisüveget sterilizálás után ne öblítse el.
- Az etetőcumit sterilizálás után ne érintse meg. Az etetőcumit a menetes gyűrűvel együtt fogja meg.

MELEGÍTÉSI utasítások:

- Melegítéshez az alábbi módszerek egyikét alkalmazza: helyezze üvegmelegítő készülékbe; meleg folyóvíz alá; egy meleg vizet tartalmazó edénybe vagy mikrohullámú sütőbe. Győződjön meg róla, hogy a grill funkció ki van kapcsolva.
- **SOHA NE** töltse forrásban lévő vizet a cumisüvegbe.
- **SOHA NE** melegítse a hűtsön lezárt üveget. Távolítsa el a védőkupakot és az etetőcumit (a menetes gyűrűvel) melegítés előtt, különösen cumisüveg melegítőben való melegítés és mikrohullámú sütőben történő melegítés előtt. Ne melegítse túl, mert az károsíthatja a cumisüveget.
- **SOHA NE** tegye a cumisüveget hagyományos sütőbe. **SOHA ne** melegítse az üveget nyílt lángon vagy tűzőn.
- Legyen fokozott figyelemmel a mikróban történő melegítésnél, mert lokalizált túlmelegedés léphet fel. Hagyja hűlni a mikrohullámú sütő gyártója által ajánlott ideig. Ne tegye a cumisüveget a forgótányér középre, mert az egyenetlen hőelosztást eredményezhet.
- **SOHA ne** melegítse az ételt tartalmazó cumisüveget 70°C fölé.
- Melegítés után tekerjen konyharuhát vagy törölközőt a cumisüveg aljára, és óvatosan döntse meg az üveget többször egymás után, hogy a főlösleges víz kiszivároгjon az alapból.
- Melegítés után ajánlott megszorítani a cumisüveg alját.
- Melegítés után mindig alaposan keverje meg az egyenetlen hőelosztás érdekében. Javasoljuk, hogy inkább keverje, mint rázza az ételt, hogy elkerülje a levegőbuborékokat, amelyek kólikás hasfájást okozhatnak.

- Mindig ellenőrizze a hőmérsékletet felhasználás előtt.

További fontos információk:

- A cumisüveg polipropilénből készült. Ez egy higiénikus, könnyen tisztítható, viszonylag lágy anyag. Kerülje a cumisüveg erős összenyomását.
- Ne használjon tűt vagy más éles tárgyat az etetőcumi nyílásának megnagyobbításához.
- Ne hagyja a babát önállóan étkezni.
- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Az etetőcumikat és szelepeket száraz, zárt tárolóban tárolja.
- Az anyatej fagyasztásához a MAM Tejtároló poharát használja.
- A MAM cumisüvegekhez csak MAM etetőcumikat használjon.
- Csak cukor hozzáadása nélkül készült ételt vagy folyadékot használjon.
- A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy gyermeke ivás közben járkáljon.
- SOHA ne tegye a babát cumisüveggel az ágyba. Folyadékokkal való hosszas érintkezés súlyos fogszuvasodást okozhat.
- Az etetőcumi az összes MAM szélesnyakú cumisüveggel és Trainer+ tanulóphórárral kompatibilis.
- Kérjük őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatához.

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében: **FIGYELEM!**

- Folyadékok tartós és hosszú ideig tartó ivása a cumisüvegből súlyos fogszuvasodáshoz vezethet.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.
- Sérülés vagy anyaggyengeség első jelénél azonnal dobja el a terméket.
- Minden nem használt alkatrész úgy tároljon, hogy a gyermekek ne érhék el.
- Soha ne rögzítse zsinórra, szalagra, csipkére vagy ruházat laza részére. Az a gyermek fulladását okozhatja.
- Soha ne használja az etetőcumit cumiként.
- A termék mindig csak felnőtt felügyelete mellett használható.